



HISTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Dr. Ricardo Tito Amor

ricardotitoamor@yahoo.com.ar

III - Separador autoestático para artrodesis del retro y medio pie

Dr. Isidro Castillo Odena

Para la exposición de la articulación subastragalina posterior media y anterior y el seno del tarso nos ha sido siempre útil el uso de dispositivos para mantener separados el calcáneo y el astrágalo, autoestáticos, que nos permiten una adecuada y prolija decorticación de las superficies articulares.

La remoción del cartílago articular no se hace difícil a nivel de las grandes articulaciones, pero sí lo es en las pequeñas como por ejemplo la subastragalina posterior; al respecto decimos que: una correcta decorticación va a redundar en un mejor resultado post-operatorio.

Usamos sistemáticamente el separador del autor que tiene una forma en X: su porción distal con dos pequeños cilindros canulados que dan paso a sendas clavijas cortas de tres milímetros; en el medio el ajuste de su pieza y hacia proximal un sistema a cremallera que nos va a permitir separar las zonas a osteotomizar. Las dos superficies articulares quedan así expuestas con toda facilidad permitiendo así realizar su condrectomía.

Se ofrecen imágenes del separador ya comentado, como así también su bibliografía.

- Autoestatic separator for athrodesis
- Isidro Castillo Odena MD Bs As Argentina
- From orthopedic and Traumatological Service Policlinico Argerich Bs As
- Journal of Bone and Joint Surgery Vol Pag 161 1952






HISTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Separador autoestático para artrodesis del retro y medio pie

Dr. Isidro Castillo Odena

Se adjuntan imágenes del separador mencionado, sus ramas, su cremallera y la separación lograda para exponer las articulaciones del retropie:

Imágenes 1-2 y 3

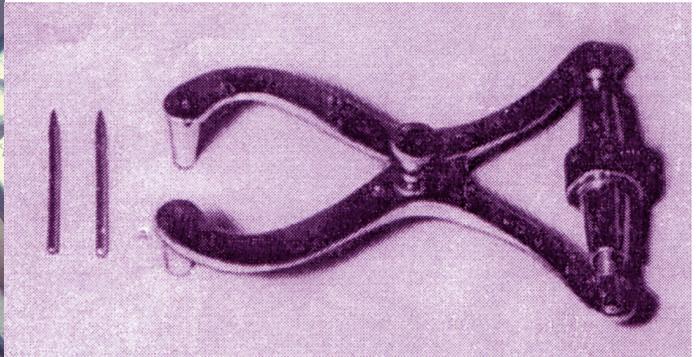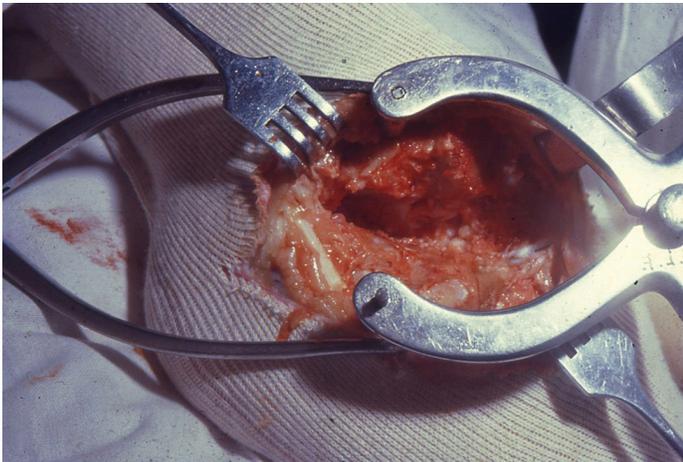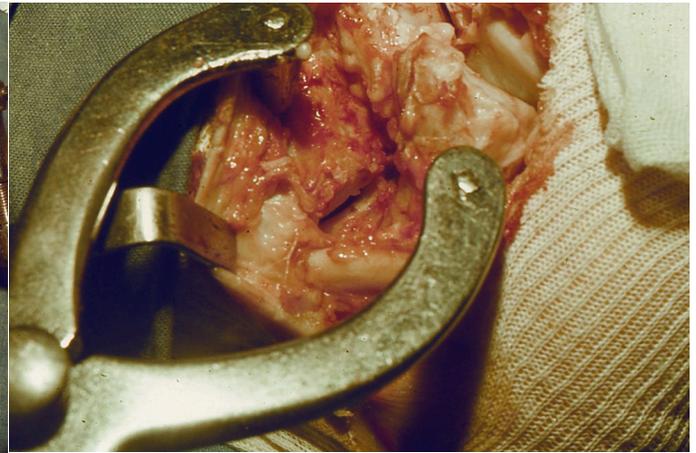



HISTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

